
Допологовий фетальний монітор

FC1400

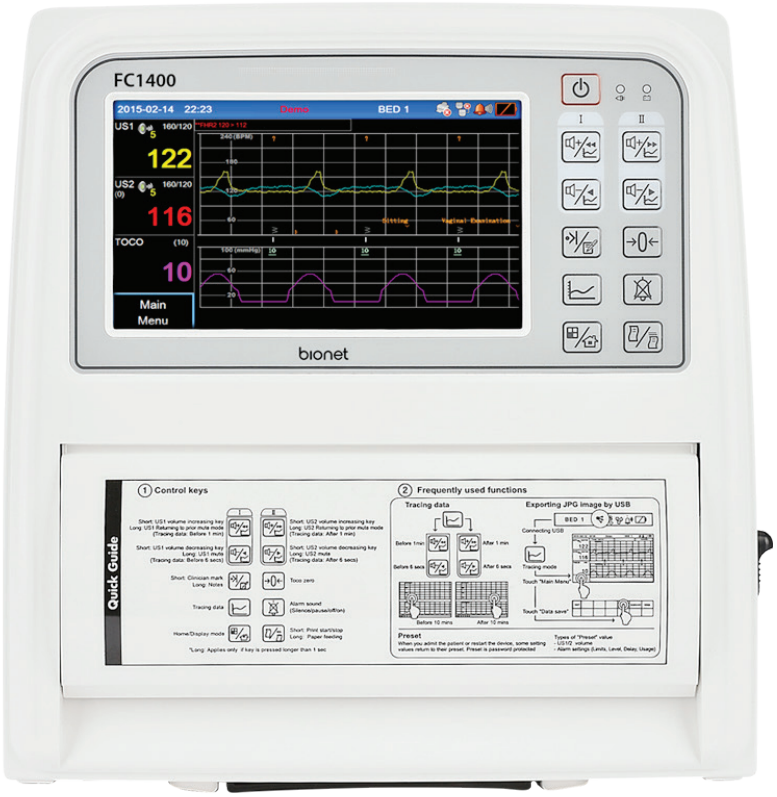


Найпотужніші функції та інтуїтивні операції з FC1400

- LED-індикатор тривог для швидкої реакції на технічні та фізіологічні зміни
- Кольоровий сенсорний дисплей з діагоналлю 7" та роздільною здатністю 800x480
- Компактний датчик та надійний конектор
- Зручна функція USB Збереження даних & Wi-Fi конвертер
- Інтуїтивно-зрозумілі 10 клавіш для швидких функцій
- Подача паперу для нотаток

bionet
www.ebionet.com


FC1400



- LED-індикатор тривог
Для швидкої реакції на технічні та фізіологічні зміни



- Зручна функція USB
Збереження даних
& Wi-Fi конвертер



- Кольоровий сенсорний дисплей з діагоналлю 7" та роздільною здатністю 800x480



- Інтуїтивно-зрозумілі кнопки для швидких функцій



- Компактний датчик та надійний конектор



- Подача паперу для нотаток

- **Центральна станція фетального моніторингу**



До 16 моніторів



HIS Server



FC Central (Сервер)




До 10 клієнтів

FC Central (Клієнт)


2 режими дисплея

- Графічний режим: для загального моніторингу або контролю стану плода
- Текстовий режим: для швидшого та зручнішого сприйняття стану плода з великої відстані

Графічний режим

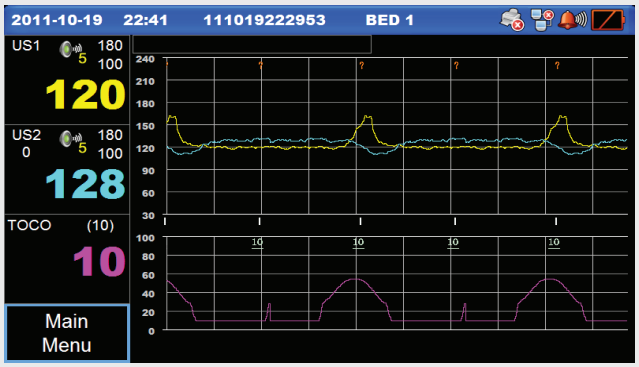



Текстовий режим

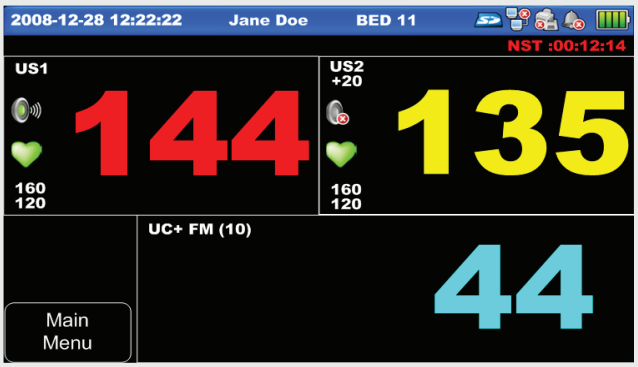

Звіт про інтерпритацію CTG

- Для більш комфортного та легкого читання користувачами
- До 4 годин і 30 хвилин даних

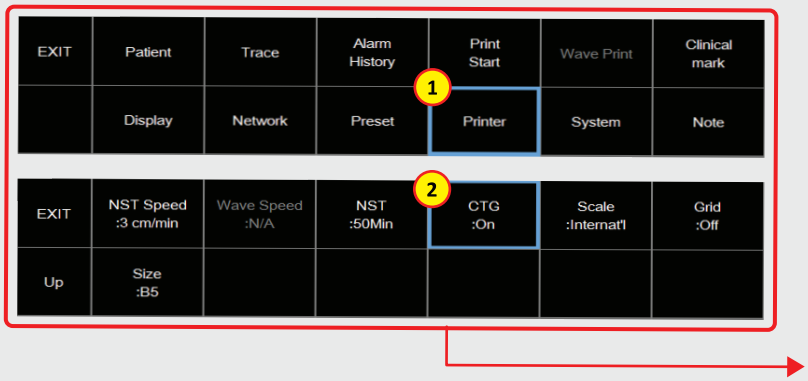


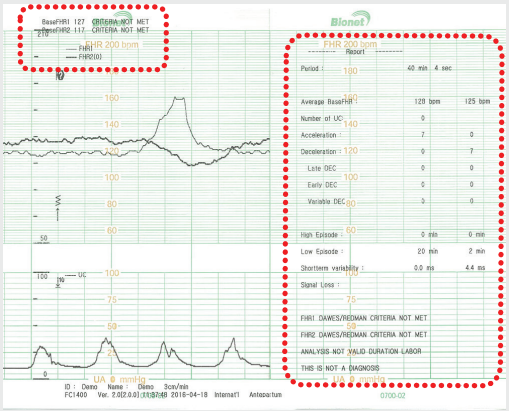


Введення примітки зі списку приміток

- Примітка відображається у статусному рядку дисплея та додається до фетального графіку
- Існує 4 стандартні примітки, а користувач може задокументувати до 100 власних приміток



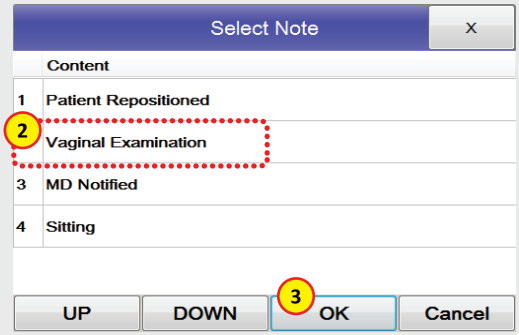

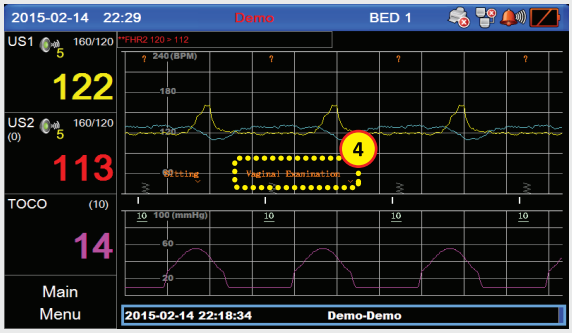

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Розміри	296 (Ш)x305.5(В)x97.5(Г) мм, вага 2.9 кг
Дисплей	Сенсорний TFT LCD з діагоналлю 7" з роздільною здатністю 800x480
Принтер	Метод: термодрук з матричним принципом Тип: рулонний Швидкість друку: 1, 2, 3 см/хв (в реальному часі) 30 см/хв (графік, 2, 3 см/хв) 20 см/хв (графік, 1 см/хв) Функція подачі паперу
Живлення	Вхід: 100-240 В, 1.5-0.7 А, 50-60 Гц. Вихід: +18В - 2.8А
Акумулятор (опція)	Li-ion: 4 год (час заряджання) 2 год (час безперервної роботи)
Зовнішні підключення	LAN, Wi-Fi, USB
Частота серцевих скорочень плоду (FHR)	Джерело сигналу: ультразвуковий імпульсний доплер Частота ультразвуку: 1.0 МГц, 975 кГц Потужність ультразвуку: <10 мВт/см^2 Метод виявлення FHR: автокореляція Діапазон FHR: 50 ~ 210 уд/хв Похибка FHR: ± 1 уд/хв
Тонус матки (TOCO)	Джерело сигналу: зовнішній датчик Керування: кнопка швидкого увімкнення, автоматичне обнулення Діапазон вимірювання: 0 ~ 99
Вимірювання рухів плода	Джерело сигналу: ультразвуковий імпульсний доплер, маркер подій
Збереження даних	До 72 годин
Автоматичний аналіз кардіотокограми (CTG)	Середній базальний рівень FHR Кількість скорочень матки Кількість прискорень Кількість сповільнень Пізні сповільнення Ранні сповільнення Варіабельне сповільнення Епізоди підвищення Епізоди зниження Короткочасна варіабельність Втрата сигналу * аналіз CTG друкується кожні 10 хв (проміжний звіт)
Аксесуари (базові)	Датчик US (2 шт.), датчик TOCO (1 шт.), маркер подій (1 шт.), папір (2 рулони), кабель живлення (1 шт.), гель (1 шт.), пояс для датчиків (3 шт.)
Аксесуари (опційні)	Акумулятор, що перезаряджається; стимулятор

* Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
* Компанія Bionet залишає за собою право змінювати конструкцію, упаковку, технічні характеристики та функції, зазначені в цьому документі, без попереднього повідомлення чи зобов'язань.
* Під час використання нестандартних або сторонніх аксесуарів може виникати спотворення сигналу або шуми. Наполегливо рекомендуємо використовувати лише авторизовані аксесуари, які постачає наша компанія.

Headquarters
Bionet Co., Ltd.
5F, 61 Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 08375
TEL. 02 6292 6410
E-Mail. info.sales@ebionet.com

2023-Bionet(FC1400)-R1