SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE



Ваш партнер у хірургії
Операційні столи DIAMOND©



Філософія компанії

Маючи понад 90 років досвіду, компанія SCHMITZ є одним із провідних у світі виробників медичної продукції.

Сімейний бізнес із живими традиціями. Наші працівники в середньому працюють у компанії близько 18 років, що є доказом того, наскільки сильно вони ототожнюють себе з нашими цінностями та філософією.

У 2012 році управління компанією перейшло до Фрідріха та Маттіаса Шмітців, четвертого покоління родини.

Ми пишаємося тим, що знаходимося в Німеччині, і глибоко вкорінені в нашому рідному регіоні. Ми розробляємо та виготовляємо тут.

90% наших постачальників – із Німеччини, з яких 60% – з нашого регіону.

Made in Germany

«Перехід до наступного покоління — це завжди щось особливе».




SCHMITZ

Філософія турботи

Ми усвідомлюємо, що наші послуги є життєдайними, і ставимо за мету досягти максимального задоволення клієнтів. Від консультації через планування до встановлення.

Економічна ефективність завдяки довговічності – це те, що ви можете від нас очікувати.

Завдяки добре продуманій концепції обслуговування та всебічній підтримці компанія SCHMITZ працює з вами як партнер від початку до кінця.

Служба технічної підтримки клієнтів
Тел.: +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

«Відданість справі з пристрастю та увагою до деталей — експерти в усіх сферах».


Штаб-квартира
у Вікеде (Рур),
Німеччина
Швейцарія
Франція
Італія
Іспанія
США
Аргентина
Понад 80 міжнародних торговельних партнерів
Офіси продажів

SCHMITZ – у всьому світі




SCHMITZ
DIAMOND



DIAMOND® CE MD
Операційний стіл для найвибагливіших потреб.

Готовий до будь-яких вимог
DIAMOND® відповідає вимогам кожної хірургічної дисципліни в операційній.

Ідеально продумана концепція експлуатації
Гарантує безпечне та контрольоване використання. Відповідає вимогам майбутнього завдяки новітнім технологіям.

Новий підхід до використання
Функція пам'яті попередніх налаштувань забезпечує ідеальний робочий процес завдяки інтуїтивно зрозумілій і комфортній експлуатації.

Вантажопідйомність і гнучкість у будь-якому положенні
Наш інноваційний дизайн відповідає вибагливим професійним вимогам.

Необмежена функціональність
Високий стандарт концептуального рішення забезпечує оптимальний доступ і високий рівень рентгенпрозорості.

Приладдя для DIAMOND®
Різноманітність варіантів дозволяє персоналізувати операційний стіл, удосконалюючи ваше робоче місце відповідно до потреби.









Подвійна система живлення







DIAMOND®
Багаторівнева система безпеки забезпечує безперебійність хірургічних процедур

Дізнайтеся більше про дворівневу систему безпеки DIAMOND®!

Дворівнева система безпеки для всіх функцій стола.
Знімний ручний пульт аварійного керування для постійного зручного регулювання стола (для моделей DIAMOND® 40: доступний як варіант). Додаткове ручне гідравлічне регулювання всіх функцій стола за допомогою вентилів попереднього вибору та ножного насоса. Спочатку виберіть потрібну функцію, а потім активуйте регулювання рухів за допомогою ножних педалей. Додатковий механізм блокування в гідравлічній системі забезпечує додаткову безпеку для всіх електрогідравлічних рухів стола. Це означає, що пацієнт завжди розташований у безпечному положенні.

Ножні педалі з обох боків для центрального блокування
та активації додаткового напрямного колеса.

Чотири акумуляторні модулі,
які згруповані в два незалежні акумуляторні блоки, забезпечують достатнє живлення протягом понад двох тижнів для 100 хірургічних втручань у середньому. Два джерела живлення забезпечують експлуатаційну готовність стола та гарантують незалежне від мережі електрогідравлічне регулювання всіх функцій стола.

Операційним столом DIAMOND® можна керувати, навіть якщо кабель живлення підключено.
Вбудований зарядний пристрій, додаткова кнопка вибору на центральній точці для живлення від мережі та режиму роботи від акумуляторної батареї, клема вирівнювання потенціалів і мережевий вимикач. Усі з'єднання та кнопки захищені від бризок.

Тумблер із функцією плавного запуску
гарантує точне переміщення стола, наприклад, під час операції на хребті або в нейрохірургії, завдяки плавному запуску двигунів.



Кольоровий дисплей із підсвічуванням

Клавіші запуску для активації додаткових функцій

Клавіша навігації по меню для виборудодаткових функцій, а саме:
– поздовжнє зміщення
– позиції згинання/розгинання
– електричне регулювання подовжувача секції спинки функцією ниркового моста
– функція пам’яті

Кнопка УВІМК./ВИМК. для активації ручного пульта керування

Положення

Зворотний режим

Положення «0»

Вбудовані світлодіоди для підсвічування пульта керування

Великий дисплей із підсвічуванням

Положення «0»

Кнопка УВІМК./ВИМК. для активації ножного пульта керування




Навігація по меню та положення

DIAMOND©
Безпека при експлуатації та для пацієнта

Ручний пульт керування
Великий кольоровий дисплей високої роздільної здатності та клавіатура з підсвічуванням. Уся інформація про стан стола, наприклад, поточне вибране положення, позиціонування в зворотному режимі та відображення заряду акумуляторної батареї, з одного погляду. (додатково бездротовий ручний пульт керування з Bluetooth®)

Ножний пульт керування
З дисплеєм із підсвічуванням і великими кнопками керування для бажаних функцій стола. Світлодіоди, що встановлені в підйомному кронштейні, освітлюють панель ножного керування навіть у затемненій операційній. (додатково бездротовий ножний пульт керування з Bluetooth®)

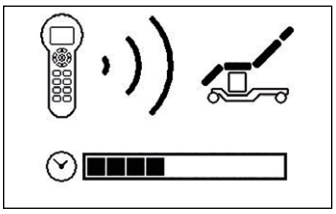

Приклади інформації про стан стола на дисплеї
Пульт керування Bluetooth® підключається до операційного стола DIAMOND®.

Бездротове керування за допомогою Bluetooth®
Технологія Bluetooth® забезпечує безперервну експлуатацію операційного стола, крізь стерильні чохли чи щось подібне, що може знаходитися між пультом керування та операційним столом.

Пульт керування Bluetooth® встановлює зв’язок виключно з призначеним операційним столом, тому немає небезпеки випадкової активації іншого пристрою. Двонаправлене з’єднання постійно відстежує поточний стан операційного стола та відображає його на кольоровому дисплеї ручного пульта керування.

Bluetooth® наявний у продажу не в усіх країнах, будь ласка, зв’яжіться з нами!









IEC IECEE CB SCHEME

Ref. Certif. No.
DE1-63695

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product	Operating table
Name and address of the applicant	Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG Zum Ostenfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr) GERMANY
Name and address of the manufacturer	Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG Zum Ostenfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr) GERMANY
Name and address of the factory *Note: When more than one factory, please report on page 2*	Schmitz & Soehne GmbH & Co. KG Werk Boenen, Rudolf-Diesel-Straße 5, 59199 Boenen, GERMANY ☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	110 - 120 V AC; I -max. 4 A; 50/60 Hz 220 - 240 V AC; I max. 2 A; 50/60 Hz INT 1,5 min. ON / 8,5 min. OFF
Trademark (if any)	SCHMITZ
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	
Model / Type Ref.	DIAMOND 40; DIAMOND 50; DIAMOND 60 maybe followed by suffix "K", "LK", "BK" , "BLK"
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	☐ Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-2-46:2016
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	264220-TL4-1, 264220-TL4-2, 264220-TL4-3

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE *Testing and Certification Institute*
Zertifizierungsstelle und internat. Angelegenheiten
Certification Body and internat. Affairs

Date: 2020-06-24 Signature: G. Heine

DIAMOND®
Безпека при експлуатації та для пацієнта

М’який знімний матрац SAF
М’які матраци з високоякісної піни з ефектом пам’яті допомагають правильно розташувати пацієнта та запобігають появі пролежнів. Вони зменшують тиск, непроникні для рідини та електропровідні. Легко кріпляться до стола за допомогою клейких гелевих смужок.

Вбудовані датчики
попереджають користувача візуально за допомогою дисплея, звуком за допомогою попереджувального звукового сигналу і тактильно за допомогою вібросигналу про неминуче зіткнення й автоматично зупиняють рух стола (залежно від моделі). Однак попередження можна заблокувати у будь-який момент (див. також сторінки 18 - 21).

Запобігання ненавмисному руху стола
за допомогою функції автоматичного вимкнення ручного пульта керування через 60 секунд (регулюється). Крім того, механізми регулювання секцій для голови та ніг захищені від ненавмисного спрацьовування. З міркувань безпеки для регулювання стола одночасно можна використовувати лише один ручний пульт керування.

Регулювання окремих сегментів стола
проводиться поетапно, отже це комфортно для пацієнта. Відсутня небезпека одночасного регулювання кількох елементів.

Випробувано щодо дотримання умов безпеки згідно з методикою, що погоджена із сертифікаційним органом, відповідно до IEC 60601
SCHMITZ відповідає всім вимогам стандарту не тільки щодо маркування CE, але й IEC 60601, випробувано незалежним і уповноваженим німецьким випробувальним інститутом.

DIAMOND®CE MD
Програмне забезпечення та електроніка, які орієнтовані на майбутнє

Завдяки власно розробленим електронним компонентам і програмному забезпеченню операційний стіл DIAMOND® відповідає вимогам майбутнього. Регулярне оновлення нових функцій програмного забезпечення є гарантованим.



Зарядна станція
Індуктивне заряджання ручного пульта керування Bluetooth® у зарядній станції. Обирайте зарядну станцію на підставці, на бічній напрямній або практичне настінне кріплення. Правильне рішення для зберігання ваших елементів керування Bluetooth®, більше жодних випадкових кабельних розведень. Операційним столом можна керувати за допомогою ручного пульта, коли він знаходиться в зарядній станції.



Активація рухом
Автоматична активація ручного пульта керування при його підніманні. Більше не потрібно шукати кнопку ввімкнення/вимкнення під час роботи в затемнених операційних.



Збереження положень у пам'яті
Можна зберегти до восьми індивідуально вибраних положень і швидко та легко отримати доступ до них одним натисканням кнопки. Збережене положення відображається графічно на дисплеї.

Персоналізоване положення «0»
Збереження персональних налаштувань висоти за допомогою кнопки положення «0» дозволяє легко перенести пацієнта на ліжко або транспортний засіб.



Пульт керування з підсвічуванням
Пульт керування з підсвічуванням для безпечного та зручного використання навіть у затемненій операційній.



Вібрація ручного пульта керування
Тактильний зворотний зв'язок для виявлених небезпек, наприклад, попередження про зіткнення, дозволяє медичному персоналу зосередитися на пацієнті.



Функція плавного запуску
Коли йдеться про міліметри! Операційні столи DIAMOND® мають функцію плавного запуску для точного налаштування. Це дозволяє здійснювати регулювання з точністю до міліметра завдяки плавному запуску двигунів.

Модуль інтеграції SCHMITZ
для додаткової інтеграції операційного стола DIAMOND® в Storz OR1™ або іншу центральну систему керування, безпечна двонаправлена передача даних. Скористайтеся порадами від наших експертів.

Експлуатаційні характеристики залежно від моделі



Експлуатаційні характеристики залежно від моделі

Система датчиків DIAMOND®

❶ Датчики гальм

З міркувань безпеки стіл можна переміщати лише за допомогою елементів керування, коли гальмо колеса активовано. Користувача інформують про те, що гальмо колеса має бути задіяне, візуально на дисплеї, тактильно за допомогою вібрації та звуком за допомогою попереджувального сигналу. Гальмо колеса не залежить від живлення стола.

❷ Система виявлення зіткнень

Аналогічно, вбудовані датчики запобігають переміщенню операційного стола в місці з'єднання секцій спинки та ніг до того, як відбудеться очікуване зіткнення. Для цього оцінюються поточні значення положення поздовжнього зміщення, латеральних нахилів, Тренделенбурга/ зворотного Тренделенбурга та висоти. Попередження можна заблокувати в будь-який момент. Як у всіх інших датчиків зіткнення, наявне візуальне, тактильне або звукове попередження.

❸ Система датчиків телескопічної підйомної колони

Система розпізнає коли предмети застрягли між панелями колони та опорною секцією і негайно зупиняє регулювання висоти, запобігаючи пошкодженню стола. Можна скористатися функцією регулювання висоти, щоб підняти стіл і безпечно видалити предмет.

❹ Стан акумуляторної батареї операційного стола

Можна перевірити поточний стан акумуляторних батарей стола за допомогою спеціального меню на ручному пульті керування. Показники напруги та температури надають персоналу інформацію про можливі пошкодження або несправності.


❺ Індикатор заряду акумуляторної батареї

Пульти керування постійно показують поточний стан акумуляторної батареї. При 20% ємності на екрані відображається індикатор низького заряду акумуляторної батареї.


Важливо!
На наступних сторінках надається інформація про вибрані повідомлення про стан операційного стола.

Також зверніть увагу на інформацію в інструкції з використання DIAMOND®!


DIAMOND® CE MD
Приклади повідомлень про стан стола

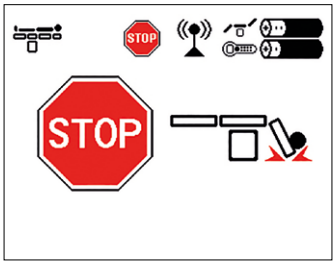


Попередження про загрозу зіткнення в головній частині стола.

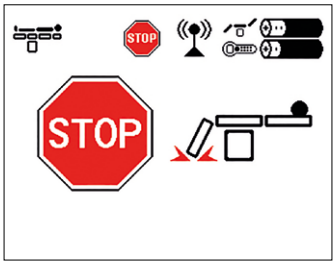


Попередження про загрозу зіткнення в ножній частині стола.

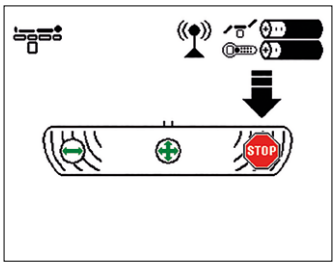


Notification to activate the castor brake in order to move the table.

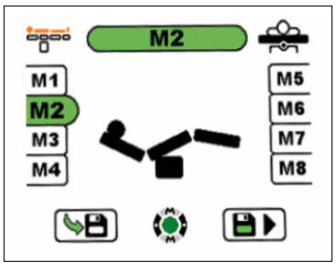


Візуальне відображення збереженого положення в меню пам’яті.

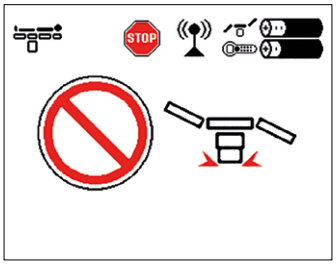

Повідомлення про те, що між панелями колони та опорною секцією виявлено предмет.

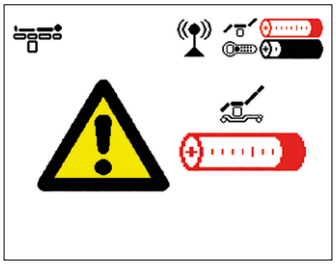

Повідомлення про низький заряд акумуляторної батареї.

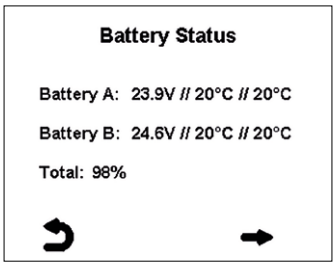

Інформація про поточний стан встановленої в столі акумуляторної батареї.













DIAMOND® CE MD
Гігієна

Матраци фіксуються клейкими гелевими смужками,
щоб вони трималися на місці. Однак їх можна відрегулювати так, щоб розташувати відповідно до потреб пацієнта.

Легке очищення
клейких гелевих смужок за допомогою вологої тканини. Клейкі гелеві смужки стійкі до дезінфекційних засобів, що створює оптимальні гігієнічні умови всередині операційної.

Захист при хірургічних втручаннях із великою кількістю рідини
Додатковий захист від бризок для центральної точки живлення на основі операційного стола DIAMOND® захищає під час операцій із великою кількістю рідини, наприклад, в урології або акушерстві.

Візок для чищення
Навіть нижню частину операційного стола DIAMOND®, яка часто є критичною проблемою з точки зору гігієни, можна зручно очистити за допомогою візка для чищення. Операційний стіл DIAMOND® переміщується в апарат так, щоб стільниця була в найвищому положенні, а рама візка для чищення розташовується під секцією сидіння стола. Опускання стільниці піднімає основу стола над підлогою та відкриває доступ до нижньої сторони для очищення.


DIAMOND







DIAMOND® CE MD
Мобільність і ергономічність

Висока стабільність під час переміщення і маневреність завдяки додатковому 5-му колесу та великим подвійним колесам діаметром 125 мм. Переміщення пацієнтів на крутих поворотах або довгими коридорами можна здійснити з мінімальними зусиллями. DIAMOND® також можна легко переміщати всередині операційної відповідно до вимог хірургічного втручання. Самовирівнювальна основа, без використання гальмівних систем з електроприводом може автоматично компенсувати нерівності підлоги до 10 мм.

Колеса з ковпачками для захисту від бризок


Педалі з трьома функціями з обох боків основи стола забезпечують:

- Прямий рух з активацією 5-го колеса для пересування довгими коридорами або повороту на місці. Стіл DIAMOND® зберігає стабільність під час переміщення, навіть коли пацієнт лежить на стільниці.
- Вільне маневрування з неактивованим 5-м колесом, наприклад, всередині операційної, щоб задовольнити вимоги до зміни положення під час хірургічного втручання.
- Функція гальмування з блокуванням усіх колес, що забезпечує високу стабільність (5-те колесо доступне як додаткове приладдя).

Вбудовані втоплені ручки
Вбудовані втоплені ручки спрощують транспортування, кріплення та видалення елементів.

Дізнайтеся більше про механізм попереднього вивільнення DIAMOND®!

Секції для голови та ніг знімаються натисканням кнопки
Швидка та безпечна заміна означає, що пацієнта можна розташувати при будь-якій конфігурації стола. Елементи стола та все вставне приладдя можна легко і надійно прикріпити завдяки кнопці та механізму попереднього вивільнення, що полегшує робочий процес для персоналу. Вбудовані втоплені ручки спрощують транспортування, кріплення та видалення елементів.

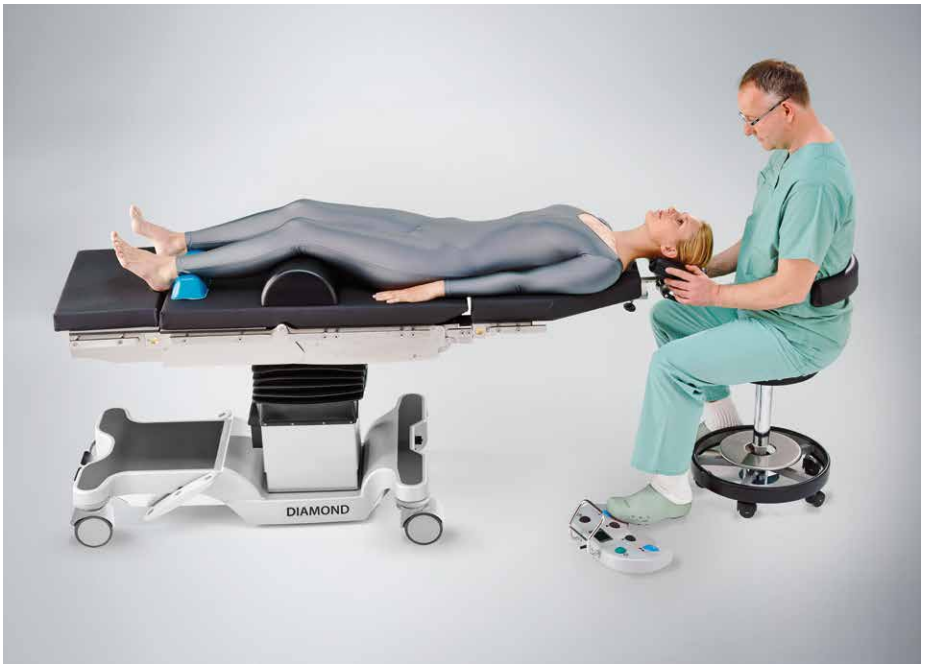
DIAMOND


OND


DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Простір для ніг і стабільність

Функція зворотного режиму
Завдяки функції зворотного режиму DIAMOND® пропонує чудовий простір для ніг хірургічної бригади та водночас покращену інтраопераційну рентгеноскопію. Зворотний режим дозволяє налаштувати операційний стіл відповідно до всіх вимог під час хірургічного втручання.

Простір для ніг
Форма основи стола забезпечує оптимальний простір для ніг хірурга.

Висока стабільність
на стиснення та розтягнення дозволяє приймати складні положення за допомогою пристрою для ортопедичного витягування.



Малоінвазивна хірургія



Висока вантажопідйомність
до 454 кг

DIAMOND® CE MD
Працюйте безпечно, навіть при великому навантаженні

Надійність – навіть при великих навантаженнях
Маючи статичне робоче навантаження до 454 кг, операційний стіл DIAMOND® ідеально обладнаний для будь-якого типу процедури завдяки ретельно підібраним і міцним компонентам, а також перевіреній гідравлічній системі. Секції для голови та ніг, а також подовжувач секції спинки дозволяють безпечне робоче навантаження до 360 кг як у звичайному положенні, так і у зворотному режимі з динамічним рухом.

Безпечне позиціонування пацієнта
Навіть пацієнтів із важким ожирінням можна безпечно розмістити на операційному столі DIAMOND®. І сам операційний стіл, і його додаткове приладдя розроблені для ефективного та зручного розміщення пацієнта та допомоги хірургам у роботі.

Відповідне приладдя для будь-якого положення
Чи то ремені для фіксації ніг, секції для ніг, чи подовжувачі стола – асортимент приладдя для операційних столів DIAMOND® розроблений таким чином, щоб відповідати всім часто використовуваним положенням. Універсальний операційний стіл для будь-яких хірургічних втручань.


DIAMOND


1,470 мм
DIAMOND


1,040 мм
DIAMOND


1,680 мм
DIAMOND


DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Поздовжнє регулювання та рентгеноскопія

Рентгеноскопія без обмежень

Стільницю DIAMOND® можна змістити в довжину на 300 мм (моделі DIAMOND® 40 LK і DIAMOND® 60 BLK). Таким чином, поверхня досягає 2100 мм, що еквівалентно приблизно 98% горизонтальної поверхні, забезпечує рентгеноскопію пацієнта без обмежень і оптимізує простір для ніг і стоп. В комплексі з тонкою колоною максимальної ширини близько 300 мм, це спрощує доступ для С-дуги.

Оптимізований доступ для використання С-дуги

Завдяки можливості поздовжнього зміщення стільниці операційний стіл DIAMOND® оптимізований для рентгеноскопії за допомогою С-дуги.

Оптимізований доступ для С-дуги, дізнайтеся більше!

Карбонове приладдя

Можна прикріпити карбонову пластину для подальшого покращення процедури рентгенівського дослідження та доступу до операційної зони. Лише на головному кінці стола це збільшує можливу площу рентгенівського випромінювання до 1680 мм.



Додаткові подвійні панелі


у стільниці операційного стола DIAMOND® дозволяють використовувати всі звичайні рентгенівські касети.



Торакальне положення





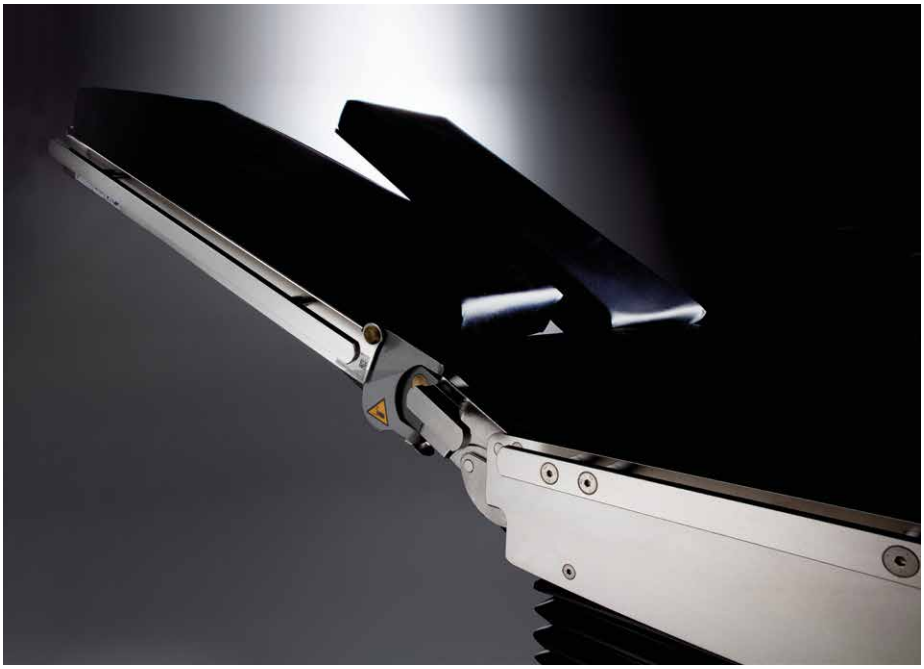

DIAMOND® CE MD
Експлуатаційні характеристики


Подовжувач секції спинки з електричним регулюванням
з функцією ниркового моста демонструє гнучкість застосування операційного стола DIAMOND® для всіх хірургічних дисциплін.
Це означає, що операції на грудній клітці або жовчному міхурі можна проводити в положенні пацієнта лежачі на боку або на спині. Подовжувач можна приєднати в разі потреби, а не тримати постійно прикріпленим на столі.

Функція електрогідравлічного регулювання секції для ніг і опори для ніг, яка також здійснює регулювання секції спинки в зворотному режимі,
забезпечує точне розміщення пацієнта та коригування положення під час операції. (залежно від моделі)

Великий діапазон регулювання висоти
Оптимальний доступ до операційного поля як під час проведення операцій стоячи, так і сидячи. Ергономічна робота хірурга без втоми.

Багаторівнева телескопічна підйомна колона – виробництва SCHMITZ
з підійманням на 500 мм і початковою висотою до 620 мм (залежно від моделі). Невибаглива в обслуговуванні конструкція телескопічної підйомної колони гарантує тривалий термін служби.



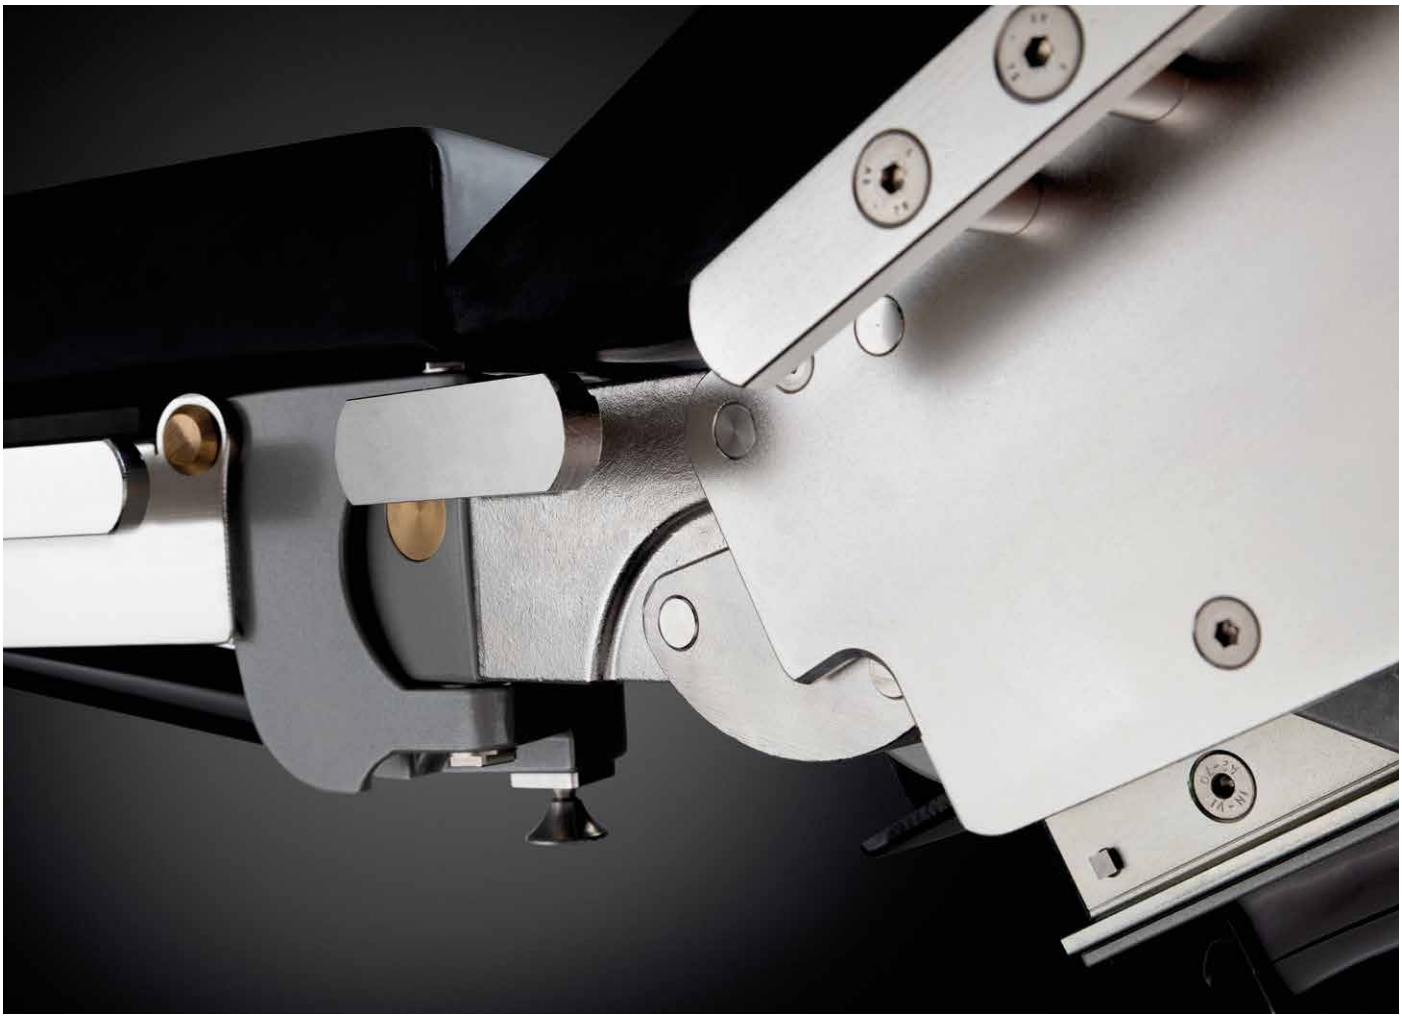

DIAMOND® CE MD
Виробничий стандарт


Німецька якість виготовлення
«Виготовлено в Німеччині» — це набагато більше, ніж девіз.
Маючи виробничі потужності у Бонені та 90% наших постачальників із Німеччини (60% з яких навіть із нашого регіону), ми є справді німецьким підприємством, яке втілює високі стандарти виробництва. Уникаючи непотрібного транспортування з-за кордону, ми також намагаємось зробити свій внесок у захист навколишнього середовища!

Операційний стіл DIAMOND® лідирує серед операційних столів за своїми можливостями та характеристиками в кожній хірургічній дисципліні – надійність на найвищому рівні.

Матеріали преміальної якості
Нержавіюча сталь найвищої якості, вставки з нержавіючої сталі виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі V4A – стійкої до корозії, з гладкою поверхнею, малої ваги та легкої в очищенні.

reddot design award

Made in Germany

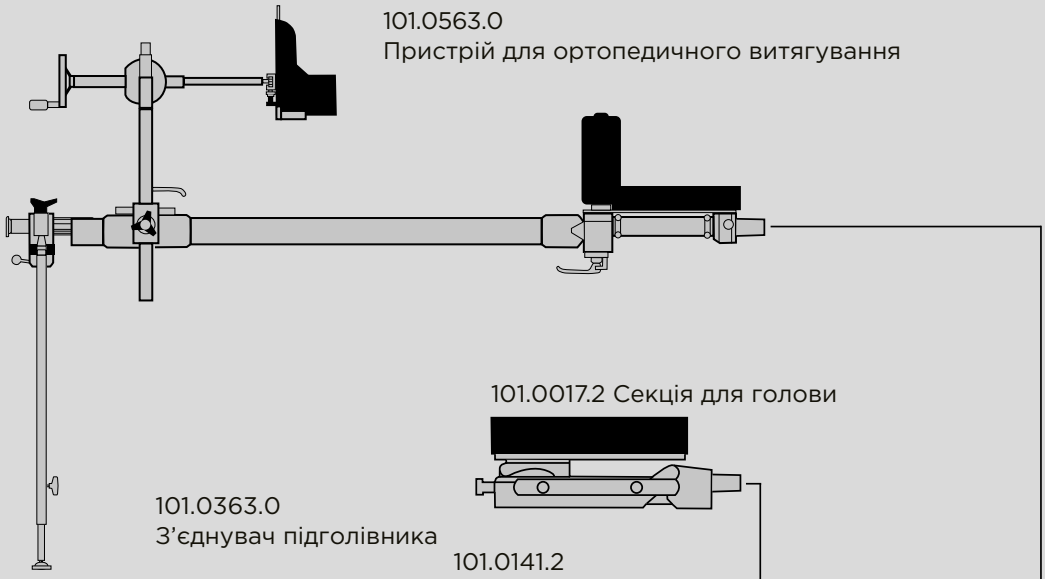


101.0563.0
Пристрій для ортопедичного витягування

101.0017.2 Секція для голови


101.0363.0
З'єднувач підголівника

101.0141.2
Універсальний адаптер


101.0179.0 Підголівник у формі підкови

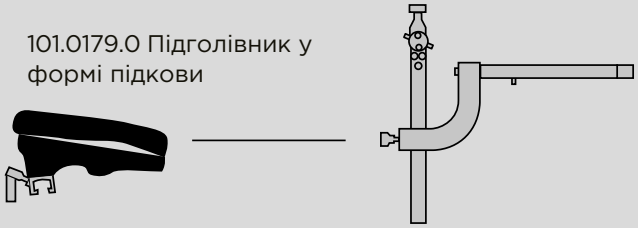


101.0159.0
Подовжувач секції спинки, з можливістю нахилу





101.0131.1
Подовжувач секції спинки, фіксований




101.7151.1 Карбонова пластина






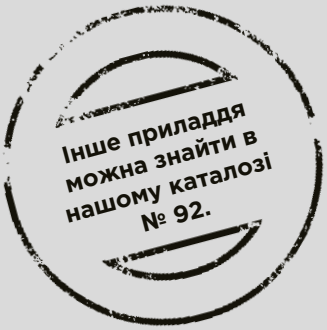

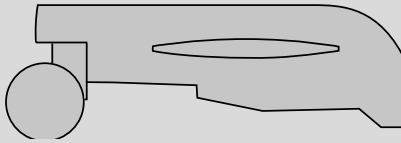

DIAMOND®
Окремі приклади варіантів приладдя

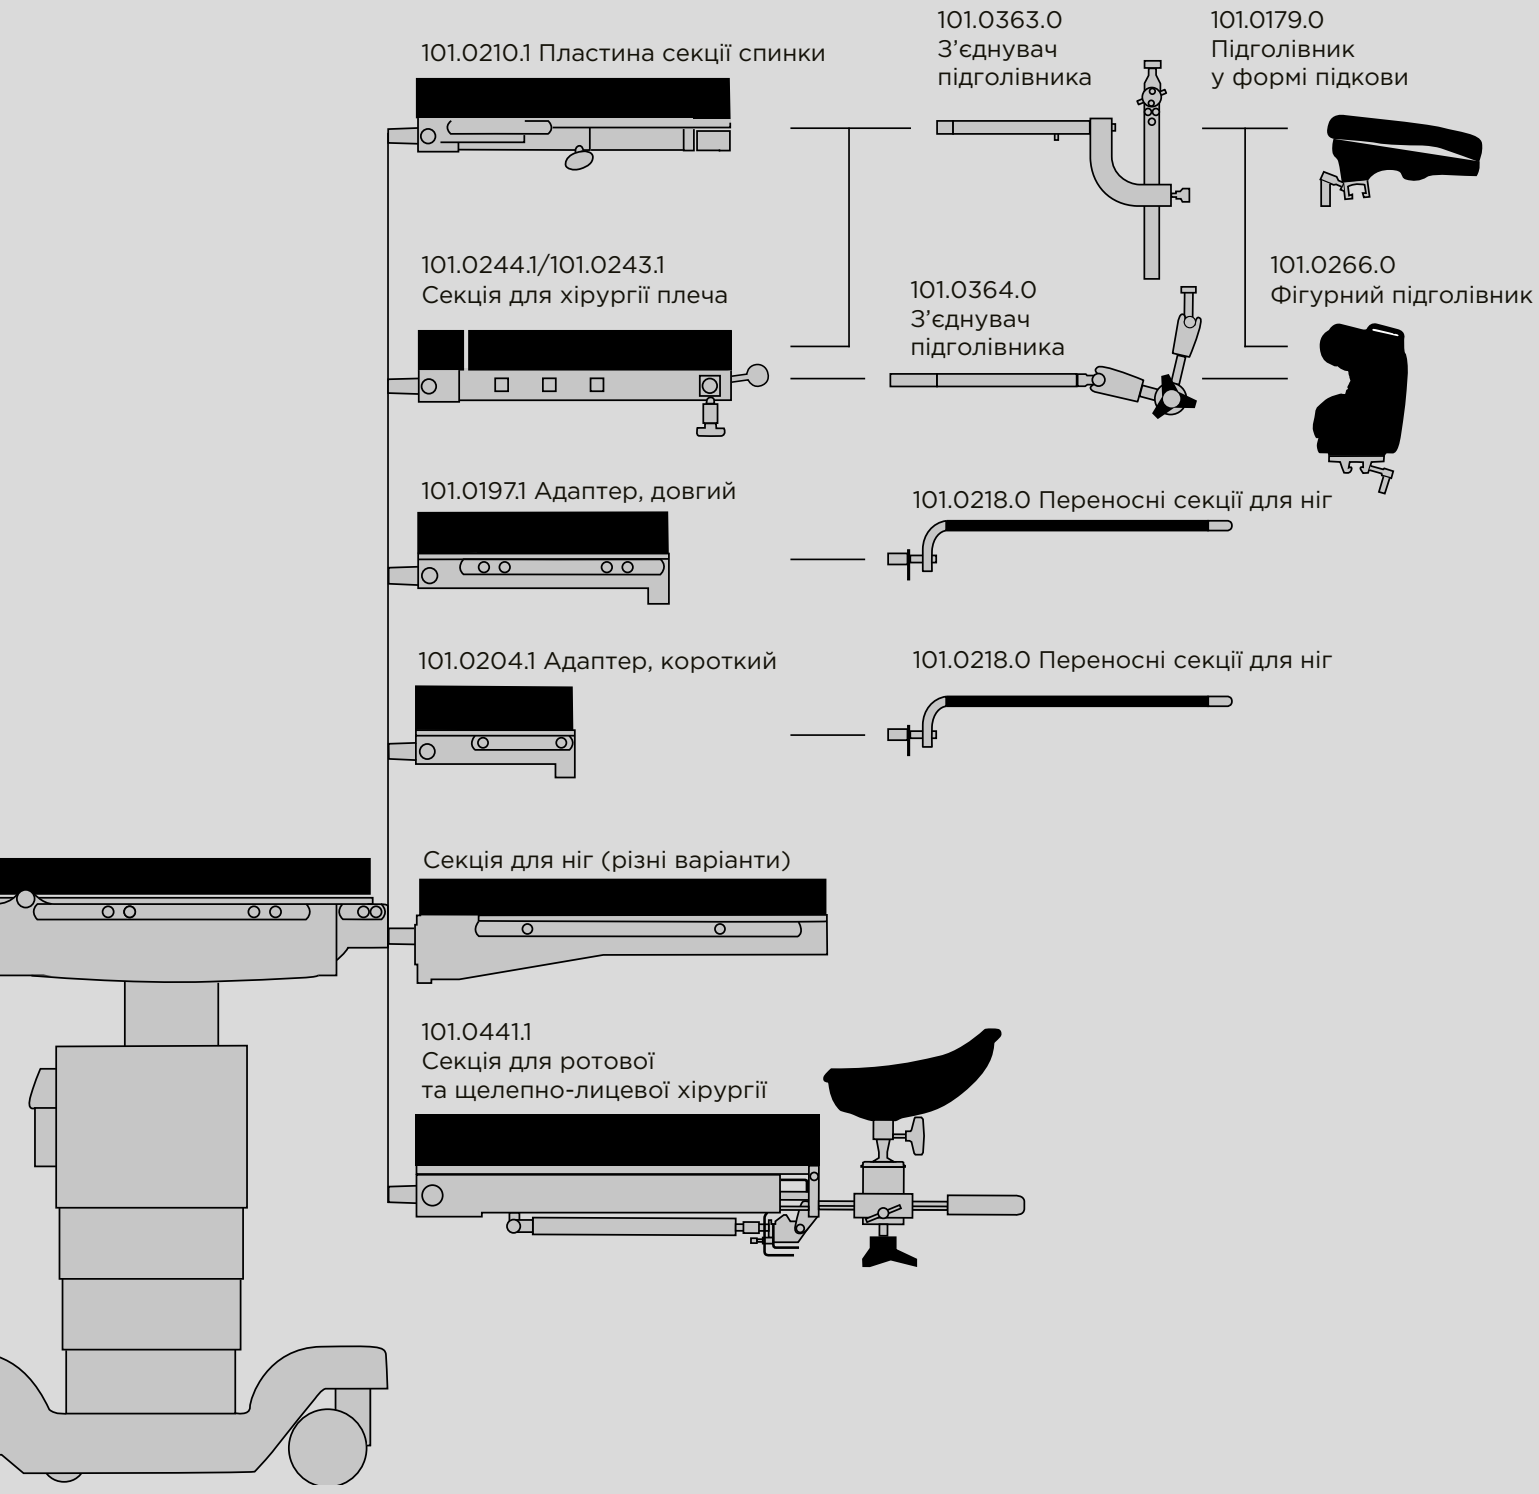

Додаткові варіанти конфігурацій описані в посібнику з експлуатації.



Торакальна хірургія/ниркова хірургія



Гінекологія



Артроскопія плечового суглоба



Позиція витягування – перелом стегнової кістки/операція на кульшовому суглобі


SCHMITZ
DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Базові моделі

Модель №	Опис



170.4001.1 **DIAMOND® 40 K**

Універсальний операційний стіл з електрогідравлічним регулюванням за допомогою додаткового пульта керування 4 функціями стола: **вверх/вниз, латеральні нахили, Тренделенбург/зворотний Тренделенбург, секція спинки.** Налаштування цих функцій за допомогою додаткового знімного пульта аварійного керування (електрогідравлічного), модель № 101.0361.0 або аварійних ручних маховиків і ножного насоса (гідравлічного). З вирізом для гінекології або без вирізу для гінекології, на вибір. Акумуляторні батареї. Вбудований зарядний пристрій із мережевим кабелем. Пересувний на 4 подвійних колесах із центральним блокуванням, 2 колеса антистатичні, 1 з 4 колес із блокуванням руху. **Без секцій для голови та ніг, подовжувача секції спинки та пульта керування.**



170.4002.1 **DIAMOND® 40 LK**

аналогічно моделі DIAMOND® 40 K, але додатково: **функція електрогідравлічного поздовжнього зміщення стільниці** на 300 мм для оптимального використання рентгенографії. **Без секцій для голови та ніг, подовжувача секції спинки та пульта керування.**

101.0361.0 **Пульт аварійного керування DIAMOND® 40**

знімний пульт керування з кабельним підключенням для всіх функцій регулювання стола відповідно до функцій ручного/ножного пультів керування, розташований на колоні стола.


DIAMOND® CE MD
Базові моделі

Модель №	Опис



170.5500.1 **DIAMOND® 50 BK**

Універсальний операційний стіл з електрогідравлічним регулюванням за допомогою додаткового пульта керування 5 функціями стола: **вверх/вниз, латеральні нахили, Тренделенбург/ зворотний Тренделенбург, секція спинки, секція для ніг.** Додаткове регулювання цих функцій за допомогою знімного пульта аварійного керування (електрогідравлічного) або аварійних ручних маховиків і ножного насоса (гідравлічного).
З функцією пам'яті для 8 вільно вибраних положень і персоналізованого положення «0». З вирізом для гінекології або без вирізу для гінекології, на вибір. Акумуляторні батареї. Вбудований зарядний пристрій із мережевим кабелем. Пересувний на 4 подвійних колесах із центральним блокуванням, 2 колеса антистатичні, 1 з 4 колес із блокуванням руху. **Без секцій для голови та ніг, подовжувача секції спинки та пульта керування.**

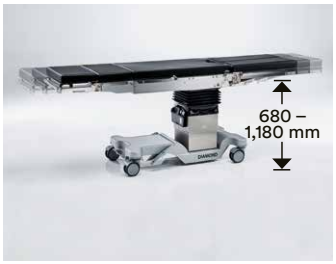

170.6000.1 **DIAMOND® 60 BLK**

аналогічно моделі DIAMOND® 50 BK, але додатково: **функція електрогідравлічного поздовжнього зміщення стільниці** на 300 мм для оптимальної рентгенографії. **Без секцій для голови та ніг, подовжувача секції спинки та пульта керування.**

Модель №	Опис	
101.0227.0 (без зображення)	**5-те напрямне колесо** додаткове підпружинене п’яте колесо для моделей DIAMOND®, що активується двосторонньою ножною педаллю, не підлягає заміні. Замінює колесо з блокуванням руху.	
101.0430.0 (без зображення)	**Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для операційних столів DIAMOND® із вирізом для гінекології.	
101.0213.0 (без зображення)	**Підкладки 80 мм за додаткову плату** для всіх моделей DIAMOND®.	**Surcharge**


STOP


F1, F2:
T 3,15A H 250V
F1
F2

DIAMOND®
Стандартна комплектація

Двокомпонентна рентгенпрозора стільниця, що містить:

- секцію спинки
- секцію сидіння з вирізом для гінекології
  (опціонально: без вирізу для гінекології)

Електрогідравлічне регулювання положень:

- вверх/вниз
- Тренделенбург/зворотний Тренделенбург
- латеральні нахили
- секція спинки
- секції для ніг (DIAMOND® 50 BK і DIAMOND® 60 BLK)
- поздовжнє зміщення (DIAMOND® 40 LK і DIAMOND® 60 BLK)

Система ручного блокування:
Незалежне регулювання функцій стола за допомогою знімного пульта аварійного керування (для моделей DIAMOND® 40: доступно як опція), електрогідравлічного та аварійних маховиків керування на колоні та ножному насосі (гідравлічному).

Рентгенпрозора стільниця, матрац SAF товщиною 60 мм, антистатичний. Конструкція каркаса стола з нержавіючої сталі, оброблена піскоструминним способом і електрополірована, стійка до дезінфекційних засобів.

Бічні рейки з нержавіючої сталі, 25 x 10 мм, з обох боків стільниці для кріплення додаткового приладдя, телескопічна колона з регулюванням висоти з панелями з нержавіючої сталі.

Панелі колони з ударостійкого АБС-пластику, сріблясто-сірого кольору, з двома пластинами з нержавіючої сталі V4A, які вставлені для захисту панелей колони, днище з нержавіючої сталі V2A. Використовується високоякісна нержавіюча сталь 1.4301.

Шасі з 4 подвійними колесами з центральним замком, 2 колеса антистатичні, 1 з 4 колес із блокуванням руху. 5-те підпружинене напрямне колесо, яке активується ножною педаллю з обох боків (додаткове приладдя). Замінює колесо з блокуванням руху.

Стіл із функцією «повернення до нуля» та виявлення загрози зіткнення (залежно від моделі). Функція пам’яті та персоналізоване налаштування положення «0» (моделі DIAMOND® 50 і 60).

Вхідна напруга джерела живлення: 115 В/230 В, 50/60 Гц.

DIAMOND® CE MD
Елементи керування



Модель №	Опис
101.0380.1	**Пульт керування, з кабельним підключенням** пластиковий корпус, герметично захищений від проникнення рідини, з кабельним підключенням. TFT-дисплей із підсвічуванням відображає всю інформацію про стан стола. Клавіатура з підсвічуванням для всіх функцій регулювання. Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0590.1 (без зображення)	**Пульт керування, з кабельним підключенням** аналогічно моделі 101.0380.1, але для моделей DIAMOND® 40, без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг.



101.0214.1	**Пульт керування, Bluetooth®** пластиковий корпус, герметично захищений від проникнення рідини, бездротове підключення Bluetooth®. TFT-дисплей із підсвічуванням відображає всю інформацію про стан стола. Клавіатура з підсвічуванням для всіх функцій регулювання. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1 і зарядна станція 101.0356.0, 101.0357.0 або 101.0358.0! Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0591.1 (без зображення)	**Пульт керування, Bluetooth®** аналогічно моделі 101.0214.1, але для моделей DIAMOND® 40, без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1 і зарядна станція 101.0356.0, 101.0357.0 або 101.0358.0!

Ми рекомендуємо завжди тримати адаптер Bluetooth® встановленим на столі, щоб мати можливість скористатися перевагами системи Bluetooth® у будь-який час.

Пульти керування Bluetooth® для моделей DIAMOND® 40 доступні лише в поєднанні з пультом керування з кабельним підключенням! Будь ласка, враховуйте це при оформленні замовлення.

Bluetooth®

Будь ласка, забезпечте наявність відповідної зарядної станції для пульта керування Bluetooth®!

Модель №	Опис
	**101.0206.1** **Ножний пульт керування, з кабельним підключенням** Литий алюмінієвий корпус, герметичний від проникнення рідин, нековзкий, із кабельним підключенням. Усі функції регулювання стола аналогічні функціям ручного пульта керування. TFT-дисплей з підсвічуванням для зручної навігації, панель керування зі світлодіодним підсвічуванням на ножній панелі (для малоінвазивних втручань). Клавіша активації та клавіша «Повернення до нуля». Можна одночасно підключити до стола разом із ручним пультом керування. Потрібен адаптер для ножного пульта керування 101.0397.0. Для моделей DIAMOND® 50/60.
(без зображення)	**101.0359.0** **Ножний пульт керування, з кабельним підключенням** для моделей DIAMOND® 40, аналогічно моделі 101.0206.1, але без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг. Потрібен адаптер для ножного пульта керування 101.0397.0!
(без зображення)	**101.0397.0** **Адаптер для ножного пульта керування, з кабельним підключенням** Адаптер для операційного стола DIAMOND® для використання ножного пульта керування з кабельним підключенням.
	**101.0216.1** **Ножний пульт керування, Bluetooth®** аналогічно моделі 101.0206.1, але з бездротовим з'єднанням Bluetooth®. У комплект входить блок живлення для заряджання пульта керування. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1! Для моделей DIAMOND® 50/60.
(без зображення)	**101.0360.0** **Ножний пульт керування, Bluetooth®** для моделей DIAMOND® 40, аналогічно 101.0216.1, але без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг.
(без зображення)	**101.0391.1** **Адаптер Bluetooth®** Адаптер для операційного стола DIAMOND® для використання ручного та ножного пультів керування Bluetooth®.


SCHMITZ



DIAMOND® CE MD
Control elements

Модель №	Опис
 **101.0356.0**	**Зарядна станція, на підставці** Варіант на підставці, зарядна станція для індуктивного заряджання пульта керування Bluetooth®, зі світлодіодним дисплеєм стану, в комплект входить мережевий адаптер. Можна продовжувати користуватися пультом керування, поки він заряджається в зарядній станції.
 **101.0357.0**	**Зарядна станція, настінне кріплення** аналогічно зарядній станції 101.0356.0, але варіант із настінним кріпленням.
 **101.0358.0**	**Зарядна станція, кріплення на бічній напрямній** аналогічно зарядній станції 101.0356.0, але варіант із кріпленням на бічній напрямній.

Bluetooth®

Будь ласка, забезпечте наявність відповідної зарядної станції для пульта керування Bluetooth®!

DIAMOND® CE MD
Базове обладнання

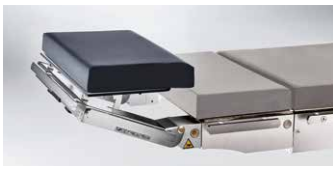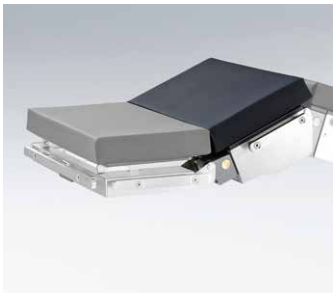
Модель №	Опис
	**101.0017.2** **Секція для голови** подвійне регулювання, автоматичне блокування нахилу матраца, вбудована газова пружина для компенсації ваги, знімна.
	101.0480.0 **Подвійна стільниця стола** (без зображення) для розміщення рентгенівської касети, для секції голови 101.0017.2.
	**101.0159.0** **Подовжувач секції спинки, з можливістю нахилу** для кріплення до секції спинки, для розтягування верхньої частини тіла пацієнта при хірургії грудної клітки та черевної порожнини, нахил вниз до 40°за допомогою електромотора, довжина 300 мм, включаючи адаптований матрац для секції для голови. Потрібен адаптер для приладдя з електричним регулюванням 101.0238.0!
	101.0238.0 **Адаптер для приладдя з електричним регулюванням** (без зображення) Адаптер операційного стола DIAMOND® для приладдя з електричним регулюванням.
	101.0580.0 **Подвійна стільниця стола** (без зображення) для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, з можливістю нахилу 101.0159.0.
	**101.0131.1** **Подовжувач секції спинки, фіксований** для кріплення до секції спинки, довжина 280 мм.
	101.0510.1 **Подвійна стільниця стола** (без зображення) для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, фіксованого 101.0131.1.

Модель №	Опис



101.0689.0 Подовжувач секції спинки, короткий
для кріплення до секції спинки, довжина 200 мм.

101.0690.0 Подвійна стільниця
(без зображення)
для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, короткого 101.0689.0.

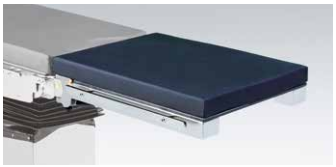

101.0145.2 Секція для ніг
односекційна, ручне складання за допомогою газової пружини, знімна.

101.0490.0 Подвійна стільниця
(без зображення)
для розміщення рентгенівської касети, для секції для ніг 101.0145.2.



101.0621.0 Секція для ніг, полегшений варіант
односекційна, полегшена конструкція (7,3 кг), без функцій регулювання, матрац з піноматеріалу з електропровідним покриттям, макс. вага 40 кг, 700 x 523 мм (Д x Ш).



101.0116.2 Секція для ніг
розділена, складана, поворотна за допомогою блокувального механізму, герметично захищена від рідин, вбудована газова пружина для компенсації ваги, знімна, з ручками для перенесення. Опціонально: без вирізу для гінекології.

101.0500.0 Подвійна стільниця
(без зображення)
для розміщення рентгенівської касети, для секцій для ніг 101.0116.2.


DIAMOND



DIAMOND



DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Універсальна секція для ніг



Модель №	Опис
101.0572.0	**Універсальна секція для ніг** Секція для ніг, що складається з чотирьох частин, плавно розширюється до 72° з кожного боку, також може бути зміщена назовні, забезпечує просвіт до 360 мм для оптимізованого доступу до робочої зони. Окремо знімні секції для гомілок, кожна з окремою функцією розширення до 45° назовні, складання до 90°, довжина плавно регулюється від 756 мм до загальної довжини 900 мм. Знімні секції для ніг із ручками для перенесення. Короткий огляд секції для ніг із чотирьох частин від SCHMITZ: • Усі характеристики звичайної секції з чотирьох частин • Секції для гомілки розсуваються та знімаються, довжина регулюється • Права і ліва сторони можуть бути зміщені назовні на всю довжину на 180 мм • Максимальна доступність для хірурга

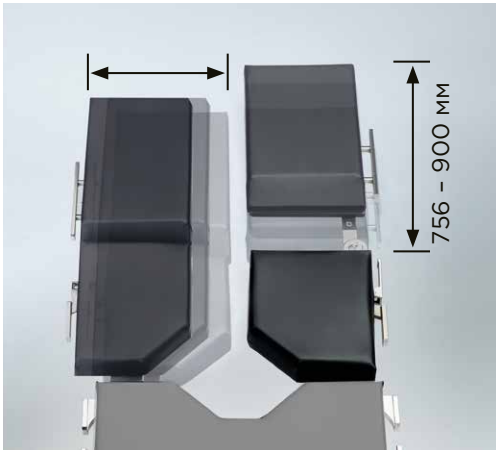


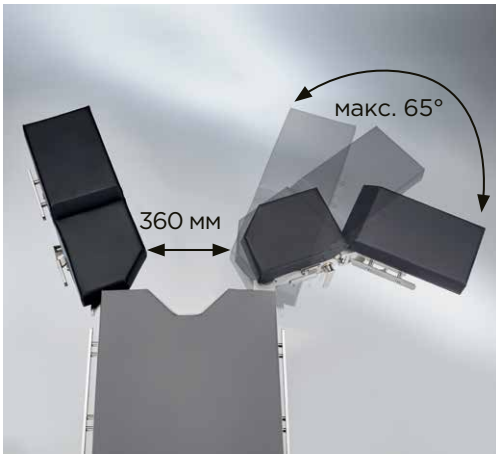




Модель №	Опис
101.0171.1	**Секція для ніг** з чотирьох частин, передня частина відкидається вниз на 155°, обертається за допомогою блокувального механізму, знімна. Короткий огляд секції для ніг від SCHMITZ: • Закрита конструкція дозволяє легке очищення, що відповідає найвищим вимогам гігієни. • Подвійна система безпеки для регулювання секції для ніг запобігає випадковому складанню нижнього сегмента. • Складання можна виконати лише після відпускання важеля безпеки та натискання ручки безпеки. Опціонально: без вирізу для гінекології.
101.0540.0 (без зображення)	**Подвійна стільниця стола** для розміщення рентгенівської касети, для секцій для ніг 101.0171.1.


Інше приладдя можна знайти в нашому каталозі № 92.

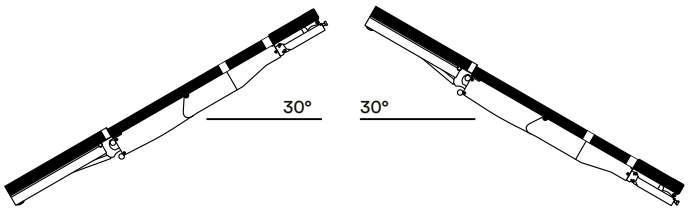


Тренделенбург/Зворотний Тренделенбург

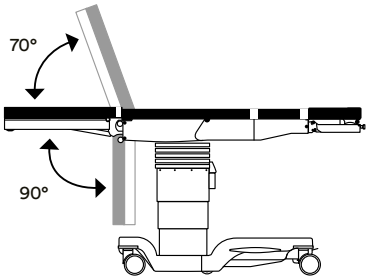


Регулювання секції для ніг




Латеральні нахили

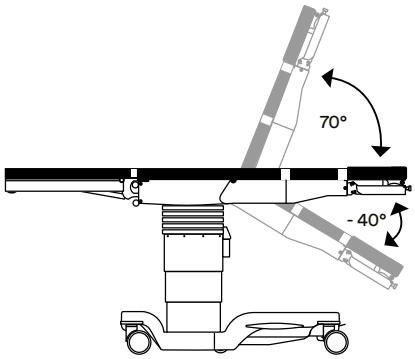


Регулювання секції спинки

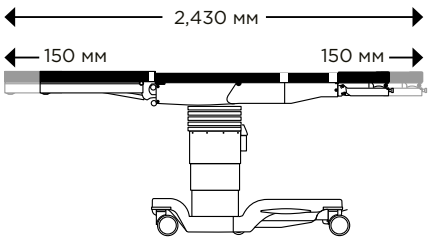


Поздовжнє зміщення
і рентгенпрозора зона

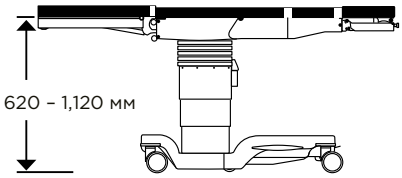


Діапазон регулювання висоти
(наприклад, DIAMOND® 50 BK)

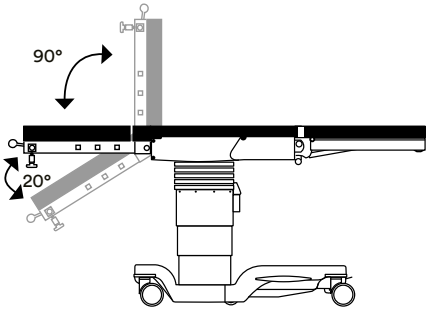


Регулювання секції спинки із
секцією для хірургії плеча

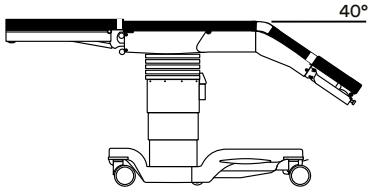

Подовжувач секції спинки,
з можливістю нахилу

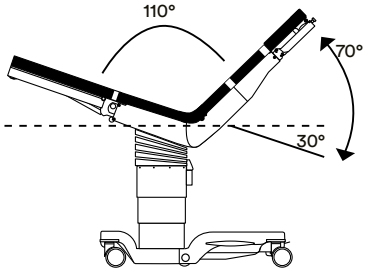

Розгинання

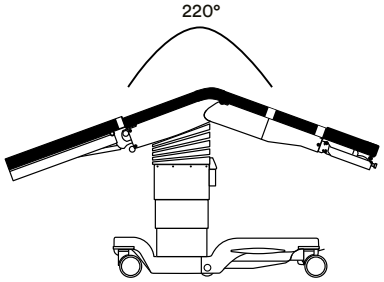

Згинання

DIAMOND®
Функції регулювання та розміри

Довжина стільниці	960 мм
Довжина секції для голови	300 мм
Довжина секції для ніг	700 мм
Ширина стільниці	550 мм
Загальна ширина	610 мм
Площа стола (довжина x ширина)	1,140 мм x 705 мм
Діаметр подвійних коліс	125 мм
Діапазон регулювання висоти (без м'якого матраца)	
• DIAMOND® 40 K	615 мм - 1,115 мм
• DIAMOND® 50 BK	620 мм - 1,120 мм
зокрема, з поздовжнім зміщенням	
• DIAMOND® 40 LK	665 мм - 1,165 mm
• DIAMOND® 60 BLK	680 mm - 1,180 mm
Тренделенбург, електрогідравлічне регулювання	30°
Зворотний Тренделенбург, електрогідравлічне регулювання	30°
Латеральні нахили, електрогідравлічне регулювання	+/- 20°
Поздовжнє зміщення (DIAMOND® 40 LK і DIAMOND® 60 BLK)	прибл. 300 мм
Рентгенпрозора секція (DIAMOND® 40 LK / 60 BLK) із поздовжнім зміщенням	
• із секціями для голови та ніг і подовжувачем секції спинки, загалом	2,100 мм
• з карбоновою пластиною, суцільна рентгенпрозора зона	1,680 мм
Секція спинки, електрогідравлічне регулювання	- 40°/+70°
• із секцією для хірургії плеча	- 20°/+90°
Електрогідравлічний нахил секції для ніг (DIAMOND® 50 BK і 60 BLK)	- 90°/+ 70°
Ручний нахил секції для ніг, за допомогою газової пружини	- 90°/+ 10°
Кут розведення секцій для ніг	120°
Нахил секції для голови, за допомогою газової пружини	- 45°/+ 25°
Кут нахилу м'якого матраца секції для голови	25°
Загальна вага (без секцій для голови та ніг)	прибл. 255 кг
Загальна вантажопідйомність (статична)	до 454 кг
Безпечне робоче навантаження (динамічне)	до 360 кг
Робота від акумуляторної батареї	■
Вбудований зарядний пристрій/мережевий адаптер	■
Аварійна робота від мережі живлення	■
Механічне аварійне блокування всіх гідравлічних функцій	
Діапазон напруги мережевого адаптера	115 В/230 В, 50/60 Гц

■ = стандартне обладнання

DIAMOND® CE MD
Рекомендоване додаткове приладдя

Загальна хірургія

Модель №	Опис
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
101.0192.0	Підлокітник
101.0123.0	Тримач зап'ястя
101.0177.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

Малоінвазивна хірургія/ лапароскопія

Модель №	Опис
DIAMOND® 60 BLK з вирізом для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
як альтернатива для 101.0116.2	
101.0572.0	Універсальна секція для ніг
альтернативно	
101.0218.0	Переносні секції для ніг
опціонально	
101.0019.0	Підлокітник
101.0123.0	Тримач зап'ястя
101.0164.0	Ремінь для фіксації ніг (2 шт.)
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель) (2 шт.)
101.0146.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)

Urology/TUR

Модель №	Опис
DIAMOND® 60 BLK/40 LK з вирізом для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
альтернативно	
101.0218.0	Переносні секції для ніг
101.0204.1	Адаптер, короткий
101.0362.0	Раковина для промивання з випускним отвором
101.0191.0	Сито для ТУР
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель) (2 шт.)
101.0146.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
101.0129.0	Підлокітники (пара)
Альтернативно для ТУР	
101.0197.1	Адаптер, довгий
101.0584.1	Раковина з гіроскопічним змиванням
101.0588.0	Сито для ТУР
101.0019.0	Підлокітник
101.0123.0	Тримач зап'ястя
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

Гінекологія

Модель №	Опис
DIAMOND® 60 BLK з вирізом для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг без вирізу для гінекології
альтернативно	
101.0218.0	Переносні секції для ніг
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель) (2 шт.)
101.0146.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
альтернативно	
101.0369.0	Опори для ніг UniLeg (пара) із протектором малогомілкового нерва
альтернативно	
101.0678.0	Опори для ніг UniLeg (пара)
101.0019.0	Підлокітник
101.0123.0	Тримач зап'ястя
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

Отоларингологія/щелепно-лицева хірургія

Модель №	Опис
DIAMOND® 50 BK or 60 BLK OR Модель операційного стола без вирізу для гінекології	
Варіант 1	
101.0017.2	Секція для голови
101.0332.0	Гелеве кільце під голову
101.0116.2	Секція для ніг
Варіант 2	**Розташування пацієнта у зворотному положенні замість секції для ніг**
101.0441.1	Секція для ротової та щелепно-лицевої хірургії
альтернативно	
101.0141.2	Універсальний адаптер
101.0179.0	Підголівник у формі підкови
101.0364.0	З'єднувач підголівника
101.0116.2	Секція для ніг для всіх варіантів
додатково, для всіх варіантів	
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0177.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла
опціонально: ножний пульт керування	

DIAMOND® CE MD
Рекомендоване додаткове приладдя

Офтальмологія

Модель №	Опис
Розташування пацієнта у зворотному положенні DIAMOND® 50 BK або 60 BLK без вирізу для гінекології	
Варіант 1	
101.0131.1	Подовжувач секції спинки, фіксований
101.0116.2	Секція для ніг
101.0019.0	Підлокітник
101.0141.2	Універсальний адаптер
101.0256.0	Підголівник у формі підкови, керування однією рукою
Варіант 2	
101.0441.1	Секція для ротової та щелепно-лицевої хірургії
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
опціонально: ножний пульт керування	
Варіант 3	
101.0210.1	Пластина секції спинки
101.0256.0	Підголівник у формі підкови, керування однією рукою
або	
101.0364.0	З'єднувач підголівника
101.0179.0	Підголівник у формі підкови

Хірургія прямої кишки

Модель №	Опис
Модель операційного стола без вирізу для гінекології	
Варіант 1, літотомічне положення	
101.0017.2	Секція для голови
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель) (2 шт.)
101.0146.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0010.0	Опора для плечей (пара)
як альтернатива для 101.0115.0/101.0146.0	
101.0572.0	Універсальна секція для ніг
як альтернатива для 101.0115.0/101.0146.0	
101.0369.0	Опори для ніг UniLeg (пара) із протектором малогомілкового нерва
або	
101.0678.0	Опори для ніг UniLeg (пара)
Варіант 2, положення лежачи на животі	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг із вирізом для гінекології
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0186.1	Опора для колін/стоп
101.0190.0	Бічна опорна підкладка (2 шт.)
101.0178.0	Опора для ректоскопії/ сідниць
101.0146.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

**Хірургія нирок/
хірургія грудної клітки**

Модель №	Опис
DIAMOND® 50 BK або 60 BLK із вирізом для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг без вирізу для гінекології
альтернативно	
101.0159.0	Подовжувач секції спинки, з можливістю нахилу
101.0352.0	Гелевий бічний позиціонувач для ніг
101.0121.0	Кронштейн для підтримки корпусу тіла (3 шт.)
101.0162.0	Опора для спини/сідниць (2 шт.)
101.0175.0	Опора для лобка
101.0192.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0177.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

Баріатрична хірургія

Модель №	Опис
Модель операційного стола з вирізом для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг із вирізом для гінекології
альтернативно	
101.0572.0	Універсальна секція для ніг
101.0194.0	Набір подовжувальних підкладок, довжина 500 мм (набір із 2 шт.)
101.0200.0	Набір подовжувальних підкладок, довжина 300 мм (набір із 2 шт.)
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0455.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла
101.0368.0	Секція для стоп (пара)
101.0010.0	Опора для плечей (пара)
101.0185.0	Ремінь для фіксації ніг
як альтернатива варіантам із використанням секцій для ніг:	
101.0219.0	Опора для ніг типу Гопель, підвищеної міцності (пара)
101.0147.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0111.0	Подовжувач анестезіологічної рамки

DIAMOND® CE MD
Рекомендоване додаткове приладдя

Хірургія хребта

Модель №	Опис
DIAMOND® 60 BLK/40 LK без вирізу для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
101.0131.1	Подовжувач секції спинки, фіксований
альтернативно	
101.7151.1	Карбонова пластина
101.7152.0	Бічна напрямна для карбонової пластини
опціонально	
101.0355.0	Гелевий позиціонувач для положення лежачи на животі, великий
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
в колінно-ліктьовому положенні	
101.0682.0	Knee/foot plates (pair)
101.0190.0	2 x Lateral support pad
101.0178.0	Rectoscopy/buttocks support
101.0146.0	2 x Clamp

Судинна хірургія

Модель №	Опис
DIAMOND® 60 BLK без вирізу для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
101.0131.1	Подовжувач секції спинки, фіксований
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
як альтернатива для 101.0116.2	
101.7151.1	Карбонова пластина
101.7152.0	Бічна напрямна для карбонової пластини

Нейрохірургія

Модель №	Опис
DIAMOND® 50 BK або 60 BLK без вирізу для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг без вирізу для гінекології
У положенні лежачи на спині/ лежачи на животі	
101.0131.1	Подовжувач секції спинки, фіксований
101.0141.2	Універсальний адаптер
101.0113.0	Адаптер для фіксатора черепа DORO
101.0142.0	Універсальний базовий блок DORO
101.0127.0	Фіксатор черепа DORO
у положенні напівсидячи/ у положенні шезлонга	
101.0014.0	Кріплення поперечини
101.0018.0	Фіксатор кріплення (2 шт.)
101.0113.0	Адаптер для фіксатора черепа DORO
101.0142.0	Універсальний базовий блок DORO
101.0127.0	Фіксатор черепа DORO
101.0019.0	Підлокітник (2 шт.)
альтернативно	
Приладдя для позиціонування голови, з рентгенпрозорого матеріалу	

Хірургія травм верхніх кінцівок

Модель №	Опис
Модель операційного стола без вирізу для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0116.2	Секція для ніг
101.0136.0	Пристрій позиціонування плечової кістки
101.0146.0	Фіксатор кріплення
101.0152.0	Протитракційна стійка для плечової кістки
101.0146.0	Фіксатор кріплення
101.0163.1	Пристрій Вайнбергера для витягування руки
101.0122.0	Секція для позиціонування плеча
101.0117.0	Фіксатор кріплення
101.0257.0	Опора для пахвової западини
101.0258.0	Опора для ліктя
101.0105.0	Тракційний пристрій
101.0123.0	Тримач зап'ястя
101.0177.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла

DIAMOND®CE MD
Рекомендоване додаткове приладдя

Хірургія травм нижніх кінцівок

Модель №	Опис
Модель операційного стола без вирізу для гінекології	
101.0017.2	Секція для голови
101.0563.0	Пристрій для ортопедичного витягування, карбон, зі стандартним приладдям: 1 секція сидіння, карбон, з підкладкою; 2 планки для витягування, карбон; 2 опори планок для витягування, нержавіюча сталь; 2 тракційні черевики для дорослих; 1 протитракційна стійка для положення на спині.
101.0566.0	Транспортний візок
101.0594.0	Протитракційна стійка для положення на боку
101.0567.0	Переносні секції для ніг (пара)

Модель №	Опис
101.0019.0	Підлокітник
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0137.0	Тримач зап'ястя
Додатково для хірургії стегнової кістки/шийки стегнової кістки	
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель)
101.0146.0	Фіксатор кріплення
101.0596.0	Подовжувач бічної напрямної
Додатково для хірургії переломів великогомілкової кістки	
101.0568.0	Тракційний пристрій при переломах великогомілкової кістки
101.0676.0	Спиця Кіршнера
101.0569.0	Пристрій для фіксації виростка
101.0115.0	Опора для ніг (типу Гопель)
101.0146.0	Фіксатор кріплення
101.0596.0	Подовжувач бічної напрямної
Додатково для артроскопії кульшового суглоба	
101.0320.0	Підкладка для артроскопії кульшового суглоба

Shoulder arthroscopy

Модель №	Опис
DIAMOND® 50 BK or 60 BLK beach chair position	
101.0244.1	Секція для хірургії плеча
101.0116.2	Секція для ніг
101.0266.0	Фігурний підголівник для хірургії плеча
101.0364.0	З'єднувач підголівника
101.0192.0	Підлокітник (2 шт.)
101.0177.1	Ремінь для фіксації корпусу тіла

Артроскопія колінного суглоба

Модель №	Опис
101.0017.2	Секція для голови
101.0171.1	Секція для ніг
101.0019.0	Підлокітник
101.0012.0	Анестезіологічна рамка
101.0137.0	Тримач зап'ястя
101.0212.0	Пристрій позиціонування коліна
101.0146.0	Фіксатор кріплення
альтернативно	
101.0583.0	Опора для артроскопії колінного суглоба


SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE

CE MD

Усі пристрої, що позначені символом CE-MD, а також наше додаткове приладдя відповідають вимогам Регламенту щодо медичних виробів 2017/745/ЄС (MDR), а також змінам до закону щодо медичних виробів і належать до медичних пристроїв класу ризику I.

CE

Усі пристрої, що позначені символом CE, відповідають вимогам Директиви про низьку напругу 2014/35/ЄС, а також регламенту щодо електричного обладнання.

Будь ласка, також зверніться до інструкції з використання, щоб отримати докладнішу інформацію про використання за призначенням!

Ми пройшли сертифікацію відповідно до DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 13485:2016

Контакти

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Поштова скринька 14 61
58734 Wickede (Ruhr) Німеччина

Тел.: +49 (0)2377 84 0
Факс: +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Відділ експорту:
Тел.: +49 (0)2377 84 0
Факс: +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Служба технічної підтримки,
гаряча лінія:
Тел.: +49 (0)2377 84 549
Факс: +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Інформацію про наші установи по всьому світу можна знайти на нашому вебсайті:
www.schmitz-soehne.com

*Цей виріб є товаром, який продається під торговельною маркою OEM.
Наші товари та послуги слід розуміти як такі, що здійснюються на умовах «франко-завод». Поставки здійснюються через наших авторизованих партнерів або філії. Компанія залишає за собою право змінювати дизайн, конструкцію, розміри та оздоблення своєї продукції без попередження. Усі відповідні розміри та вагу слід розуміти як приблизну інформацію/дані. З технічних причин колір може відрізнятися. Варіанти позиціонування пацієнта, які наведені в цьому каталозі, є лише прикладом і не претендують на правильність і/або комплектність додаткового приладдя У будь-якому випадку дотримуйтеся інструкції з використання.
Вироби, що представлені в цьому каталозі, не дозволені для продажу в США.
Номінальна вартість 3,00 євро.

Каталог SCHMITZ № 84, 01.2023, Велика Британія